

ТӨЛБӨРИЙН ХҮСЭЛТ № 00646

2020 оны 12 сарын 25 өдөр

Байгууллагын нэр: Эрүүл мэндийн яам	Дансны дугаар	Дүн тоогоор
Регистрийн дугаар: 9087443	100900020001	3,155,196,000.00
Хүлээн авагчийн нэр: Мед импекс интернэшнл ХХК	Дансны дугаар	
Регистрийн дугаар: 2763877	1102986752	
Хүлээн авагчийн банк: Голомт Банк	Ангилал	
Мөнгөн дүн үсгээр: Гурван тэр бум нэг зуун тавин таван сая нэг зуун ерэн зургаан мянган төгрөг	71601 - Нийгмийн эрүүл мэнд 81605 - Эрүүл мэндийг дэмжих 0000 - Төрийн сан 210601 - Багаж, техник, хэрэгсэл	3,155,196,000.00
Гүйлгээний утга: ЭМДТөв-д шаардлагатай тон.төх багц /Багц-1/ Г.Бат-эрдэнэ		
Хяналтын хуудас №: 00646		
Үндэслэх бичиг баримтын нэр	Үндсэн баримтын он сар дугаар	Төрийн сангийн тэмдэглэл
1.Нэхэмжлэх	2020.12.23	
2.Тон.төх хүлээн авсан комиссын акт	2020.12.23	
3.Тон.төх нийлүүлэх гэрээ №365	2020.10.29	
4.Гэрээ байгуулах эрх №2/4394	2020.10.19	

Тамга

Дарга

Гарын үсэг

Няглан бодогч




Я.Амаржаргал

Э.Эрдэнэцэцэг

Төрийн санд гүйлгээ хийсэн

.....оны.....сарын..../өдөр

Тэмдэг, гарын үсэг



ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ХҮЛЭЭН АВСАН КОМИССЫН АКТ

2020 оны 12 дугаар
сарын 23-ны өдөр

№ 365-01

Улаанбаатар хот

НЭГ.

- 1.1 Гэрээний нэр, дугаар: Эрүүл мэндийг дэмжих төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, Багц №1 Дурангийн оношилгооны тоног төхөөрөмж, №365
- 1.2 Тоног төхөөрөмжийн нэр: Багц №1 Дурангийн оношилгооны тоног төхөөрөмж
- 1.3 Захиалагч байгууллага: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ
- 1.4 Нийлүүлэгч байгууллага: МЕД ИМПЕКС ИНТЕРНЭШНЛ ХХК
- 1.5 Эрүүл мэндийн яамны тоног төхөөрөмж хүлээн авах комисс нь захиалагч, нийлүүлэгчийн хооронд байгуулсан №365 тоот гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх тоног төхөөрөмжийг гэрээний хавсралт, ерөнхий болон тусгай нөхцөлд тусгагдсан шаардлагыг хангасан байдал, барааны чанар, тээвэрлэлт, хадгалалтын байдал болон тоног төхөөрөмжийн холбогдох баримтуудыг шалгаж үзэв.
- 1.6 Тоног төхөөрөмжүүдийг 2020 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр бүрэн хүлээн авав.

ХОЁР.

- 2.1 Тоног төхөөрөмжийг шалгаж үзээд, нийлүүлэгч байгууллага гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгөхөөр гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлсэн гэж үзлээ.
- 2.2 Тоног төхөөрөмжийг захиалагч байгууллагын мэдэлд бүрэн шилжүүлж ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэв.
- 2.3 Тоног төхөөрөмж хүлээн авах комиссын акт, холбогдох баримт бичиг, материалыг 4 хувь үйлдэж захиалагч, нийлүүлэгч, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага тус бүрт 1 хувийг хүргүүлнэ.
- 2.4 Энэ актаар хүлээн авсан тоног төхөөрөмжийн бүх баримт бичиг нь дараах зүйлээс бүрдэнэ.


Үүнд:

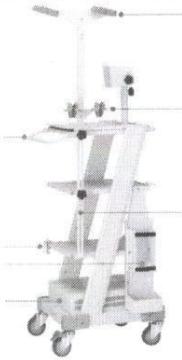


- Тоног төхөөрөмжийг дагалдах техникийн бусад баримт материал
- Баталгаат засварын хугацаа, үйлчилгээний батлагдсан хуваарь /албан бичгээр/, бичиг баримт
- Гарын авлага, удирдамж (Монгол хэлээр)
- Бусад шаардлагатай нэмэлт материалууд

ГУРАВ. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮНЭ, ТОО ШИРХЭГ

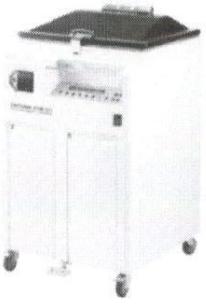

№	Нэр төрөл	Барааны гарал үүсэл		Тоо хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1.	Уян дурангийн иж бүрдэл /ходоод, уушгины дуран, with tower/	Olympus Medical Systems Corporation	Япон	6	₮ 384,824,000	₮ 2,308,944,000
2.	Дурангийн угаалгын машин	Choyang Medical Industry Co.,Ltd	Солонгос	6	₮ 50,952,000	₮ 305,712,000
3.	Дуран хатаах хадгалах шүүгээ	Hanlim Medical Equipment Co.,Ltd	Солонгос	6	₮ 13,123,000	₮ 78,738,000
4.	Үнтуулгын аппарат	Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd	Хятад	6	₮ 76,967,000	₮ 461,802,000
БҮГД ДҮН						₮ 3,155,196,000

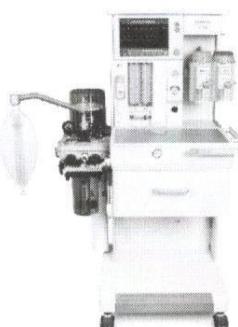
ДӨРӨВ. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Захиалсан үзүүлэлт	Нийлүүлсэн үзүүлэлт
1	УЯН ДУРАНГИЙН ИЖ БҮРДЭЛ /ХОДООД, УУШГИНЫ ДУРАН, WITH TOWER/ EXERA III/OPTERA TOWER    <p>Иж бүрдэл:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Видео процессор – 1 - Гэрэл үүсгэгч – 1 - Дэлгэц – 1 - Тавиур – 1 - Ходоодны дуран – 2 - Ушигны дуран – 1 - Дуоденоскопи – 1 - Коагуляцын аппарат – 1 - Отсос – 1 <p>ВИДЕО ПРОЦЕССОР</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тусгай гэрлийн шинжилгээний арга: Narrow Band Imaging (NBI) аргаар эрт үед нь илрүүлэх функцтэй байх - Автоматаар цагаан өнгөний тохиргоо хийх функцтэй байх - Контраст: 3 түвшингээр контраст тохируулдаг байх <ul style="list-style-type: none"> • N (Normal): Хэвийн • H (High): Хар хэсэг нь илүү хар, цайвар хэсэг нь илүү цайвар харагдах • L (Low): Хар хэсэг нь илүү цайвар харагдах, цайвар хэсэг нь илүү хар харагдах - Аналог HDTV гаралт: RGB эсвэл YPbPr (1080/50I:PAL) аль нэгийг сонгох боломжтой байх - Аналог SDTV гаралт: VBS composite, Y/C болон RGB <p>Иж бүрдэл:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Видео процессор – 1 - Гэрэл үүсгэгч – 1 - Дэлгэц – 1 - Тавиур – 1 - Ходоодны дуран – 2 - Ушигны дуран – 1 - Дуоденоскопи – 1 - Коагуляцын аппарат – 1 - Отсос – 1 <p>ВИДЕО ПРОЦЕССОР-1 (CV-190)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тусгай гэрлийн шинжилгээний арга: Narrow Band Imaging (NBI) аргаар эрт үед нь илрүүлэх функцтэй - Автоматаар цагаан өнгөний тохиргоо хийх функцтэй - Контраст: 3 түвшингээр контраст тохируулдаг <ul style="list-style-type: none"> • N (Normal): Хэвийн • H (High): Хар хэсэг нь илүү хар, цайвар хэсэг нь илүү цайвар харагдах • L (Low): Хар хэсэг нь илүү цайвар харагдах, цайвар хэсэг нь илүү хар харагдах - Аналог HDTV гаралт: RGB эсвэл YPbPr (1080/50I:PAL) аль нэгийг сонгох боломжтой 		

     	<p>(5766/50I: PAL); гаралтуудыг бүгдийг зэрэг гаргах боломжтой байх</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дижитал гаралт: HD-SDI (SMTPE 292M), SD-SDI (SMTPE 259M); DV (IEEE 1394) ба DVI (WUXGA, 1080p, SCGA) аль нэгийг сонгох боломжтой байх - Өнгөний тон тохиргоо: гаран дээрээс өнгөний тон түвшинг тохируулдаг байх. - Улаан өнгөний тохиргоо: ±8 алхамаар - Хөх өнгөний тохиргоо: ±8 алхамаар - Хрома өнгөний тохиргоо: ±8 алхамаар - Дурангийн үзүүр объектос хэт хол гэрэл хангалтгүй байх үед дүрсийг элетроноор өсгөж харуулах gautomatic gain control (ACG) функцтэй байх - IRIS функцтэй байх ба Auto, Peak, Average гэсэн 3 түвшнээр тохиргоо хийх боломжтой байх - Fog-Free буюу цаналтаас сэргийлэх функцтэй - Image enhancement буюу дүрсийг тодоруулж харах функцтэй ба уг функц нь бүтцийг болон зах хүрээг тодруулж харах сонголттой байдаг. - 2GB хэмжээтэй зөөврийн санах ойтой - 50 өвчтөний мэдээлэл хадгалдаг байх - 20 хэрэглэгчийн тохиргоо хадгалдаг байх - Монитор дээр доорх функцуудийн тохиргоог харуулдаг - structure enhancement level - edge enhancement level - zoom ratio, color mode , focus <p>ГЭРЭЛ ҮҮСГЭГЧ</p> <p>Лампны төрөл: ксенон 300Вт байх Лампны ажиллах цаг: 500 цаг байх Туслах ламп: халоген 12В, 35Вт байх Агаарын ламп: диафрагм төрлийнх байх Агаарыг 4 түвшингээр тохируuлах боломжтой байх. Off, low, medium, high Автоматаар гэрлийн эрчмийг тохируuлах функцтэй байх Forced-air аргаар хөргөл хийдэг байх</p> <p>ДЭЛГЭЦ</p> <p>Өнгөт бүрэн HD технологитой байх Хэмжээ: 26 инч байх Нягтрал: 1920 x 1080 байх Контрастын харьцаа: 1400:1 байх Өнгөний тоо: 1.07 сая байх</p>	<p>- Аналог SDTV гаралт: VBS composite, Y/C болон RGB (5766/50I: PAL); гаралтуудыг бүгдийг зэрэг гаргах боломжтой байх</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дижитал гаралт: HD-SDI (SMTPE 292M), SD-SDI (SMTPE 259M); DV (IEEE 1394) ба DVI (WUXGA, 1080p, SCGA) аль нэгийг сонгох боломжтой байх - Өнгөний тон тохиргоо: гаран дээрээс өнгөний тон түвшинг тохируuлах боломжтой байх - Улаан өнгөний тохиргоо: ±8 алхамаар - Хөх өнгөний тохиргоо: ±8 алхамаар - Хрома өнгөний тохиргоо: ±8 алхамаар - Дурангийн үзүүр объектос хэт хол гэрэл хангалтгүй байх үед дүрсийг элетроноор өсгөж харуулах gautomatic gain control (ACG) функцтэй - IRIS функцтэй байх ба Auto, Peak, Average гэсэн 3 түвшнээр тохиргоо хийх боломжтой - Fog-Free буюу цаналтаас сэргийлэх функцтэй - Image enhancement буюу дүрсийг тодоруулж харах функцтэй ба уг функц нь бүтцийг болон зах хүрээг тодруулж харах сонголттой байдаг. - 2GB хэмжээтэй зөөврийн санах ойтой - 50 өвчтөний мэдээлэл хадгалдаг байх - 20 хэрэглэгчийн тохиргоо хадгалдаг байх - Монитор дээр доорх функцуудийн тохиргоог харуулдаг - structure enhancement level - edge enhancement level - zoom ratio, color mode , focus <p>ГЭРЭЛ ҮҮСГЭГЧ-1 (CLV-190)</p> <p>Лампны төрөл: ксенон 300Вт Лампны ажиллах цаг: 500 цаг Туслах ламп: халоген 12В, 35Вт Агаарын ламп: диафрагм төрөл Агаарыг off, low, medium, high гэх 4 түвшингээр тохируuлах боломжтой. Автоматаар гэрлийн эрчимийг тохируuлах функцтэй Forced-air аргаар хөргөл хийдэг</p> <p>ДЭЛГЭЦ-1 (Barco Korea Ltd AMM261WTD)</p> <p>Өнгөт бүрэн HD технологитой Хэмжээ: 26 инч Нягтрал: 1920 x 1080 Контрастын харьцаа: 1400:1 Өнгөний тоо: 1.07 сая</p>
--	---	--

	<p>Оролт: SDI:3G/HD/SD SDI, BNC x 2, DVI, VGA, Component/ RGB, Y/C Video, Composite Video Гаралт: SDI:3G/HD/SD SDI, BNC x 1, component/RGB, Y/C video, composite video</p> <p>ТАВИУР Хэмжээ мм: 1826 (H) x 700 (D) x 650(W) байх Өндөр: 1169мм байх Даац: 85кг байх</p> <p>ХОДООДНЫ ДУРАН -2 ширхэг NBI гэрлийг горимд ажилладаг байх Харах талбай: 140 Харалты гүн: Энгийн: 3-100мм Гадна диаметр: 9.2мм Сувгийн диаметр: 2.8мм Ажлын урт: 1030мм Нийт урт: 1035мм Эргэх өнцөг: дээж 210, доош 90, баруун 100, зүүн 100</p> <p>УШГИНЫ ДУРАН-1 ширхэг NBI гэрлийг горимд ажилладаг байх HDTV гаралттай. Харах талбай: 120 Үзүүрийн хэсгийн гадна диаметр: 5.5мм Оруулах хэсгийн гадна диаметр: 5.1мм Сувгийн диаметр: 2мм Ажлын урт: 600мм</p> <p>ДУОДЕНОСКОПИ-1 ширхэг NBI гэрлийг горимд ажилладаг байх Харах талбай: Энгийн: 100° Харалты гүн: Энгийн: 5-60мм Гадна диаметр: 13.7мм Сувгийн диаметр: 4.2мм Ажлын урт: 1240мм Нийт урт: 1550мм Эргэх өнцөг: дээж 120, доош 90, баруун 110, зүүн 90</p> <p>КОАГУЛЯЦЫН АППАРАТ Өндөр давтамжийн функцийн: монополяр/биполяр Өндөр давтамжийн чадал: 120Вт байх Өндөр давтамж: 430кГц +/- 20% байх Монополяр кабель болон идэвхгүй электродын кабель тус бүр 1ш дагалдуулах Идэвхгүй электрод 10ш дагалдуулах</p>	<p>Оролт: SDI-2, DVI-1, D-SUB-1, Y/C-1, C-Video/SOG-1, R/Pr, G/Y, B/Pb, H/CS, VS-1 Гаралт: Y/C-1, C-Video x SDI, R/Pr, G/Y, B/Pb, H/CS, VS-1</p> <p>ТАВИУР-1 (TC-A1) Хэмжээ мм: 1165 (H) x 575 (D) x 485(W) Өндөр: 1165мм Даац: 85кг</p> <p>ХОДООДНЫ ДУРАН 2 ширхэг (OPTERA GIF-H170) NBI гэрлийг горимд ажилладаг Харах талбай: 140 Харалты гүн: Энгийн: 2-100мм /сайжирсан/ Гадна диаметр: 9.2мм Сувгийн диаметр: 2.8мм Ажлын урт: 1030мм Нийт урт: 1350мм Эргэх өнцөг: дээж 210, доош 90, баруун 100, зүүн 100</p> <p>УШГИНЫ ДУРАН 1 ширхэг (OPTERA BF-Q170) NBI гэрлийг горимд ажилладаг HDTV гаралттай. Харах талбай: 120 Үзүүрийн хэсгийн гадна диаметр: 4.9мм /Сайжирсан, өвчтөнд илүү зовиур багатай болсон/ Оруулах хэсгийн гадна диаметр: 4.8мм /Сайжирсан/ Сувгийн диаметр: 2мм Ажлын урт: 600мм</p> <p>ДУОДЕНОСКОПИ 1 ширхэг (TJF-Q190V) NBI гэрлийг горимд ажилладаг Харах талбай: Энгийн: 100 Харалты гүн: Энгийн: 5-60мм Гадна диаметр: 13.5мм /Сайжирсан, өвчтөнд илүү зовиур багатай болсон/ Сувгийн диаметр: 4.2мм Ажлын урт: 1240мм Нийт урт: 1560мм Эргэх өнцөг: дээж 120, доош 90, баруун 110, зүүн 90</p> <p>КОАГУЛЯЦЫН АППАРАТ-1 (ESG-150) Өндөр давтамжийн функцийн: монополяр/биполяр Өндөр давтамжийн чадал: 120Вт Өндөр давтамж: 356 kHz ±20% Монополяр кабель болон идэвхгүй электродын кабель тус бүр 1ш дагалдуулна. Идэвхгүй электрод 10ш дагалдуулна</p>
--	---	--

		OTCOS Сорох хүч: 0.90бар (675мм муб) байх Урсгал: 60л/мин байх Ажиллах цикл: үргэлжилсэн байх Хэрэглэх чадал: 230ВА байх	OTCOS-1 (GIMA ITALY -28234) Сорох хүч: 0.90бар (675мм муб) Урсгал: 60л/мин Ажиллах цикл: үргэлжилсэн Хэрэглэх чадал: 230ВА Хэмжээ: 46 x 42 x 60см Жин: 13кг
2	ДУРАНГИЙН УГААЛГЫН МАШИН CYW-501 	Дурангийн битүүмж шалгагчтай байх Угаах хугацаа: 10-50сек, 1-5мин Ариутгалын цаг: 1-9мин, 10-50мин, 1-9цаг Угаалгын бодисоор угаах: 10сек Угаах автомат горимтой А горим: Угаах-бодисоор угаах-угаах-угаах-арийтугах-угаах-спиртээр ариутгах-агаараар хатаах Б горим: Угаах-бодисоор угаах-угаах-агаараар хатаах С горим: Угаах-арийтугах-угаах-агаараар хатаах Цахилгаан тэжээл 220В/50Гц Танкны багтаамж: Ус 20 литр Халдвартгуйжүүлэх бодис: 20 литр Угаалгын бодис: 1 литр Алкохол: 1 литр Холбох хэрэгсэл: Хоёр дуран цэвэрлэх 6 гаралт Шавхалт: 4 танкны ус болон уусмал шавхдаг тус тусын холболттой байх Битүүмж шалгагч: Усан төрөл	Дурангийн битүүмж шалгагчтай Угаах хугацаа: 10-50сек, 1-5мин Ариутгалын цаг: 1-9мин, 10-50мин, 1-9цаг Угаалгын бодисоор угаах: 10сек Угаах автомат горимтой А горим: Угаах-бодисоор угаах-угаах-угаах-арийтугах-угаах-спиртээр ариутгах-агаараар хатаах Б горим: Угаах-бодисоор угаах-угаах-агаараар хатаах С горим: Угаах-арийтугах-угаах-агаараар хатаах Цахилгаан тэжээл 220В/50Гц Танкны багтаамж: Ус 20 литр Халдвартгуйжүүлэх бодис: 20 литр Угаалгын бодис: 1 литр Алкохол: 1 литр Холбох хэрэгсэл: Хоёр дуран цэвэрлэх 6 гаралт Шавхалт: 4 танкны ус болон уусмал шавхдаг тус тусын холболттой Битүүмж шалгагч: Усан төрөл
3	ДУРАН ХАТААХ ХАДГАЛАХ ШҮҮГЭЭ HL-ECK-L 	6-8 дуран хатаах, ариутгах боломтой байх U.V ламп: 15Вт, 5000 цаг ажиллах Гүйцэг шилэн хаалгатай байх Хяналтын хайрцаг - On&Off товчлуур - Хугацааны тоологч - Халаагч сэнс: 1кВт/цаг - Агаар сэлгэлтийн сэнс - Мэдрэгч	8 дуран хатаах, ариутгах боломтой U.V ламп: 15Вт, 5000 цаг ажилладаг Гүйцэг шилэн хаалгатай Хяналтын хайрцаг - On&Off товчлуур - Хугацааны тоологч - Халаагч сэнс: 1кВт/цаг - Агаар сэлгэлтийн сэнс - Мэдрэгчтэй - 304 марктийн цэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн - Хэмжээ: 1200 x 450 x 2100мм
4	ҮНТҮҮЛГЫН АППАРАТ AX-400	Дэлгэц: TFT,LCD өнгөт дэлгэцтэй байх Вапорайзер: Isoflurane, Halothane байх Амьсгалын параметрууд: - IPPV: VT, Freq., I:E, TP, PEEP - PCV: Ptarger, Freq., I:E, PEEP, TSlope - PS: FreqMIN, PEEP, P, Trigger, TSlope - SIMV: VT, Freq, Tinsp, TP, PEEP, P, Tr - TSlope - High pressure (PCV) 5 – 50 cm H2O хооронд - PEEP 4 – 30 cm H2 O хооронд - Maximum pressure control 85±2 cmH2O хооронд	Дэлгэц: 8.4 инчийн TFT, LCD өнгөт дэлгэцтэй Вапорайзер: Isoflurane, Halothane Амьсгалын параметрууд: - IPPV: VT, Freq., I:E, TP, PEEP, VCV - PCV: Ptarger, Freq., I:E, PEEP, Tslope - PS: FreqMIN, PEEP, P, Trigger, TSlope - SIMV: VT, Freq, Tinsp, TP, PEEP, P, Tr - TSlope - High pressure (PCV) 5 – 60 cm H2O хооронд - PEEP 3 – 30 cm H2O хооронд

	<p>Хийн урсгалын тун:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O2 0.05 – 1.0 L/min, 1 – 10 L/min - Air 0.05 – 1.0 L/min, 1 – 10 L/min - N2O 0.05 – 1.0 L/min, 1 – 10 L/min <p>Хийн хангамж:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Хүчилтөрөгч (O2) 280 – 600 kPa - Агаар (AIR) 280 – 600 kPa - Азотын хий (N2O) 280 – 600 kPa байх <p>CO2 шингээгчийн багтаамж: 1300 мл болон дээш байх</p> <p>Амьсгалын хүрээний дотоод эзлэхүүн: 2.5 л багагүй байх</p> <p>Амьсгалын горим: IPPV, PCV, PS, SIMV, manual</p> <p>Tidal volume: VT 20 – 1500 ml байх</p> <p>Амьсгалын давтамж: 4 – 100 bpm байх</p> <p>I:E ratio normal 4:1 1:8</p> <p>Ажиллагааг шалгах: Compliance test</p> <p>Automatic байх</p> <p>Leak test Automatic / manual</p> <p>Дэлгэцийн үзүүлэлт:</p> <p>Pressure monitor Ppeak, Pmean, Pplateau, PEEP, Flow monitor VT, MV, Freq,Waves Paw – t, flow – t, CO – t,2Loops Pressure – Volume,Flow – Volume</p> <p>Салдаг эд ангиудыг Автоклавд 134°C хүртэл ариутгах боломжтой</p> <p>Дохиолол: Аудио болон гэрлэн дохиог сонгож, тохируулан ажиллах боломжтой байх, Эзэлхүүн, Амьсгалын замын даралт (stenosis ба disconnection), Хүчилтөрөгчийн хувь, Цахилгаан тасрах, хийн урсгал, даралт хүчилтөрөгчийн мэдрэгчийг ажиллахгүй зэрэгт анхааруулах дохиотой</p> <p>Батерейн ажиллах нөөц 2 цаг</p> <p>Илүүдэл хий гадагшлуулах /AGSS-Anesthesia gas scavenging system cpl/ төхөөрөмжтэй</p>	<p>- Maximum pressure control 0 – 100cmH2O хооронд</p> <p>Хийн урсгалын тун:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O2 0.05 – 1.0 L/min, 1 – 10 L/min - Air 0.05 – 1.0 L/min, 1 – 10 L/min - N2O 0.05 – 1.0 L/min, 1 – 10 L/min <p>Хийн хангамж:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Хүчилтөрөгч (O2) 280 – 600 kPa - Агаар (AIR) 280 – 600 kPa - Азотын хий (N2O) 280 – 600 kPa <p>CO2 шингээгчийн багтаамж: 2000 мл</p> <p>Амьсгалын хүрээний дотоод эзлэхүүн: 2.5 л</p> <p>Амьсгалын горим: IPPV, PCV, PS, SIMV, manual, VCV, PCV, SIMV-VC, PSV/CPAP, SIMV-PC, PRVC, SIMV-PRVC, PSVPro</p> <p>Tidal volume: 15 – 1500 ml</p> <p>Амьсгалын давтамж: 4 – 100 bpm</p> <p>I:E ratio normal 4:1 1:10</p> <p>Ажиллагааг шалгах: Compliance test</p> <p>Automatic</p> <p>Leak test Automatic / manual</p> <p>Дэлгэцийн үзүүлэлт:</p> <p>Pressure monitor Ppeak, Pmean, Pplateau, PEEP, Flow monitor VT, MV, Freq,Waves Paw – t, flow – t, CO – t, 2Loops Pressure – Volume, Flow – Volume</p> <p>Салдаг эд ангиудыг Автоклавд 134°C хүртэл ариутгах боломжтой</p> <p>Дохиолол: Аудио болон гэрлэн дохиог сонгож, тохируулан ажиллах боломжтой байх, Эзэлхүүн, Амьсгалын замын даралт (stenosis ба disconnection), Хүчилтөрөгчийн хувь, Цахилгаан тасрах, хийн урсгал, даралт хүчилтөрөгчийн мэдрэгчийг ажиллахгүй зэрэгт анхааруулах дохиотой</p> <p>Батерейн ажиллах нөөц 2 цаг</p> <p>Илүүдэл хий гадагшлуулах /AGSS-Anesthesia gas scavenging system cpl/ төхөөрөмжтэй</p>
---	--	---

ТАВ. ХҮЛЭЭН АВСАН КОМИССЫН НЭМЭЛТ ТАЙЛБАР

5.1 Тендерт нийлүүлэхээр ирүүлсэн тоног төхөөрөмжийн үзүүлэлт тус бүрийг, нийлүүлэхээр авч ирсэн тоног төхөөрөмжүүд бүртэй нэг бүрчлэн тулган баталгаажуулж гэрээний хавсралт, ерөнхий болон тусгай нөхцөлд тусгагдсан шаардлагыг бүрэн хангасан гэж дүгнэв.

ХҮЛЭЭН АВСАН:

ЭМЯ-ЫН КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Комиссын дарга:

Т.Бямбасүрэн,
хэлтсийн дарга

Хөрөнгө оруулалтын

Нарийн бичгийн дарга:

Г.Бат-Эрдэнэ, Эдийн засаг, санхүү хөрөнгө
оруулалтын газрын Хөрөнгө оруулалтын
хэлтсийн зээл тусlamжийн бодлогын
хэрэгжилт, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

1118270972 90

Гишүүд:

А.Хандмаа, Сайдын багцын тооцооны
нягтлан бодогч

Г.Бат-Эрдэнэ, Эдийн засаг, санхүү хөрөнгө
оруулалтын газрын хөрөнгө оруулалтын
хэлтсийн тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө
оруулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

(Handwritten signature)

Б.Цэрэн-Очир, Бодлого төлөвлөлтийн
газрын цахим мэдээллийн хэлтсийн
өгөгдлийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

НИЙЛҮҮЛЭГЧ МЕД ИМПЕКС ИНТЕРНЭШНЛ КОМПАНИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Төслийн газрын захирал:

Ж.Энхболор

Төслийн эдийн засагч:

Б.Энхбат

Ахлах инженер:

С.Бямба-Эрдэнэ



БАТЛАВ:

ЗАХИАЛАГЧ:

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМНЫ
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА

Я.АМАРЖАРГАЛ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ,
/БАГЦ-№1 ДУРАНГИЙН ОНОШИЛГООНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ/ НИЙЛҮҮЛЭХ
ГЭРЭЭ

Дугаар № 365

НИЙЛҮҮЛЭГЧ:

“МЕД ИМПЕКС ИНТЕРНЭШНЛ”
ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ



Т. ОТГОНТУЯА

Улаанбаатар хот

Нэг талаас “ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ” (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас “МЕД ИМПЕКС ИНТЕРНЭШНЛ” ХХК (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) дараах зүйлийг харилцан тохиролцож 2020 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр энэхүү ГЭРЭЭГ (цаашид “гэрээ” гэх) байгуулав.

1. Монгол Улсын Иргэний хууль болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэхтэй холбогдон захиалагч, нийлүүлэгчийн хооронд үсэх харилцааг зохицуулах, харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тогтооход энэхүү гэрээний ач холбогдол оршино.

2. Эрүүл мэндийг дэмжих төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Багц-№1: “Дурангийн оношилгооны тоног төхөөрөмж”-ийг нийлүүлэхээр ирүүлсэн нийлүүлэгчийн тендерийг хүлээн зөвшөөрч гэрээ байгуулав. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн нийт гүйцэтгэл болно.

3. Захиалагч нь барааны нийлүүлэлтийг 3,155,196,000₮ /Гурван тэрбум нэг зуун тавин таван сая нэг зуун ерэн зургаан мянга/ төгрөгөөр Улсын төсвийн хөрөнгөөс санхүүжүүлнэ. 2020 онд санхүүжих дүн 3,155,196,000₮ /Гурван тэрбум нэг зуун тавин таван сая нэг зуун ерэн зургаан мянга/ төгрөгийг тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгсний дараа нийлүүлэгчийн дансанд шилжүүлнэ.

4. Нийлүүлэгч нь доорх нэр төрлийн барааг, талууд гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажсанаас хойш 30 хоногийн дотор нийлүүлж хүлээлгэж өгнө.

№	Барааны нэр	Барааны гарал үүсэл	Марк	Тоо ширхэг
	1	2	3	4
1	Уян дурангийн иж бүрдэл /ходоод, уушигны дуран with tower/	Япон улс Olympus Medical System Corp	Olympus endoscopic tower	6

2	Дурангийн угаалгын машин	Солонгос улс Choyang Medical Industry Co.,Ltd	CYW-501	6
3	Дуран хатаах хадгалах шүүгээ	Солонгос улс Hanlim Medical Equipment Co.,Ltd	HL-ECK-L	6
4	Унтуулгын аппарат	Хятад улс Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd	AX-400	6

5. Захиалагч болон нийлүүлэгч байгууллагын зүгээс үл хамаарсан хүчин зүйлсийн улмаас гэрээний зарим зүйл заалт биелүүлэх хугацаа хойшлогдсон тохиолдолд хоёр тал харилцан тохиролцож, зөвшилцэн шийдвэрлэнэ.

6. Дор дурдсан бичиг баримт нь гэрээний хэсэг болно (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:

Бусад шаардлагатай баримт бичиг;
Тендерийн баталгаа;
Тендер ба үнийн хуваарь;
Гэрээний тусгай нөхцөл;
Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
Техникийн тодорхойлолт болон бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
Санхүүжилтийн хуваарь;
Баталгаат хугацааны мэдэгдэл /албан тоот/
Гэрээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн тухай мэдэгдэл /албан тоот/

7. Гэрээ нь энд дурдсан барааны нийлүүлэлтийн талаарх талуудын хоорондын эцсийн тохиролцоо болох ба урьд өмнө үйлдсэн бүх хэлцлийг орлоно. Хэрэв гэрээний баримт бичгүүд хоорондоо зөрчилдвэл дээр дурдсан дарааллын дагуу ач холбогдол өгч шийдвэрлэнэ.

8. Нийлүүлэгч нь энэ гэрээний дагуу захиалагчийн төлөх төлбөрийг үндэслэн энэхүү гэрээний бүх нөхцөл, болзолд нийцүүлэн энд заасан барааг нийлүүлж, гэмтэл согог арилгах үүрэг хариуцлагыг хүлээж байна.

9. Захиалагч нь гэрээний дагуу нийлүүлэгчийн нийлүүлэх бараа болон гэмтэл согог арилгах үйлчилгээг үндэслэн гэрээний үнэ, эсхүл тухайн үед гэрээний заалтын дагуу төлөх бусад дүнг гэрээнд заасан хэлбэрээр нийлүүлэгчид төлөх үүрэг хариуцлага хүлээж байна.

10. Гэрээнд холбогдох асуудлаар талууд албан бичгээр буюу шуудан, телекс, цахилгаан болон факсаар харилцана.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

Эдийн засаг, санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын дарга

Д.Нарантуяа

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

Төслийн газрын захирал



Ж. Энхболор

Хуулийн хэлтсийн дарга

Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн
дарга

Т.Бямбасүрэн

Хуулийн хэлтсийн гэрээний
мэргэжилтэн

Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн
ахлах мэргэжилтэн

Г.Бат-Эрдэнэ

Хаяг: Эрүүл мэндийн яам, Засгийн
газрын VIII байр, 1 давхар 106 тоот
өрөө Улаанбаатар-48, Олимпын
гудамж-2
Утас: 51-263631, Факс: 323541

Төслийн ахлах менежер

Төслийн эдийн засагч

С. Цэлмэг

Б.Энхбат

Хаяг: Сити центр, 12 давхар, 1202
тоот, Б.Алтангэрэлийн гудамж,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р
хороо, Улаанбаатар-14200,
Утас: 976- 77111155
И-мэйл: info@medimpex.mn
Дансны дугаар: 1102986752
Голомт банк



“МЕД ИМПЕКС” ХХК-Д

МОНГОЛ УЛСЫН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ

14210 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
Олимпийн гудамж 2, Засгийн газрын VIII байр,
Утас: 26-36-95, Факс: (976-11) 32-35-41, 32-09-16
И-мэйл: moh@moh.gov.mn, http://www.mohs.mn

2020.10.19 № 2/4394
танай _____ -ны № _____ -т

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Эрүүл мэндийн яамнаас 2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр зарласан ЭМЯ/2020/09/17 дугаартай “Эрүүл мэндийг дэмжих төвд шаардлагтай тоног төхөөрөмж”-ийн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг /Багц-1 Дурангийн оношилгооны тоног төхөөрөмж/ 3,155,196,000 (гурван тэрбум нэг зуун тавин таван сая нэг зуун ерэн зургаан мянган) төгрөгөөр гүйцэтгэхээр 2020 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр ирүүлсэн танай тендерийг “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр шалгаруулж гэрээ байгуулах эрх олгох тухай үнэлгээний хорооны дүгнэлт гарсан байна.

Иймд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэгт заасны дагуу энэхүү мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 6-аас доошгүй хоногийн дараа, тендер хүчинтэй байх хугацаанд гэрээний маягтад гарын үсэг зурж, гүйцэтгэлийн баталгааны хамт ирүүлнэ үү.

Шаардлага хангасан гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлээгүй нь гэрээ байгуулах эрхийг хүчингүй болгох үндэслэл болно.

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА

Я.АМАРЖАРГАЛ

144208669